

製造番号シール等変更のご案内

ウイルスワクチン類

ロタテック[®] 内用液

生物学的製剤基準
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ロタテック[®] 内用液につきまして、製造番号シールの形状を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

また、これに伴い、検定合格年月日の表示を変更いたします。

なお、組成・性状・効能・効果及び用法・用量は従来品と変わりありません。

何卒ご了承を賜りますとともに、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。


謹白

記

●変更内容

1. 製造番号シールの変更

- ・シールの形状を変更いたします。シールの大きさに変更はございません。(幅 22mm、高さ 6mm)
 - ・シールの貼付向きを変更いたします。
 - ・シール台紙の寸法を変更いたします。
 - ・G S 1コードの表示位置をシールの下へ変更いたします。
- ※個装箱への貼付イメージは裏面をご覧ください。

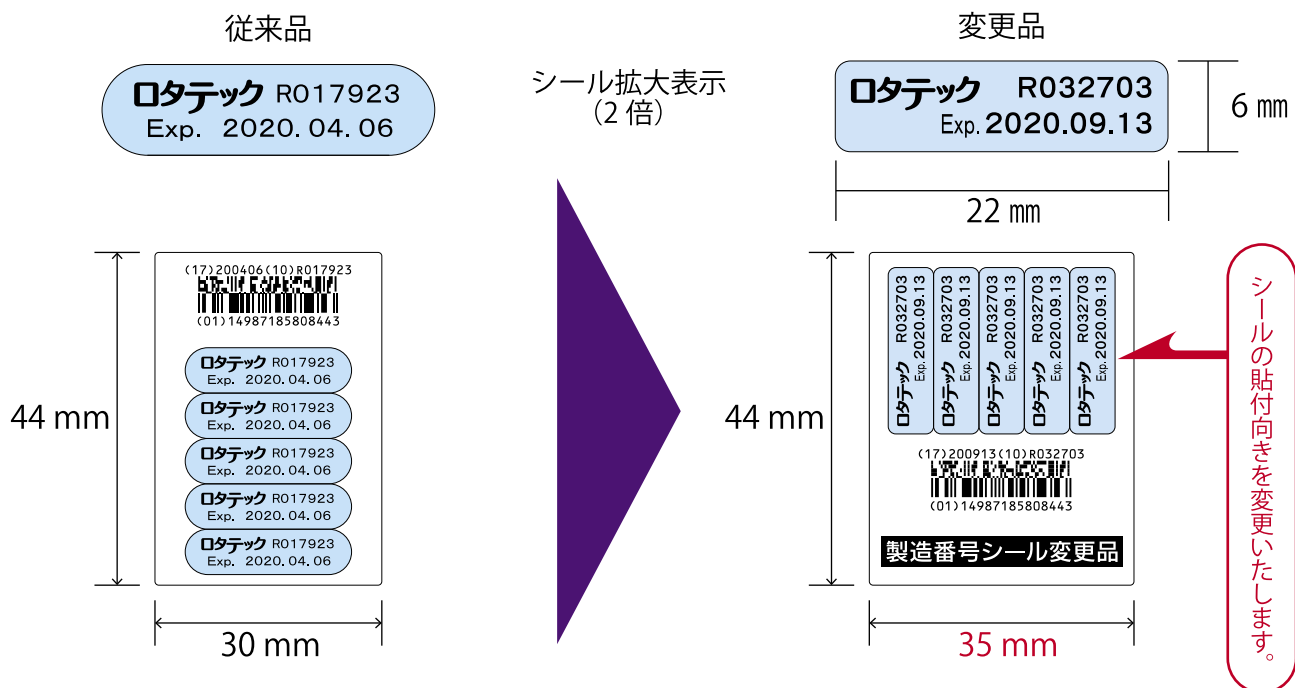

MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

※裏面をご覧ください。👉

製造番号シール等変更のご案内

個装箱への貼付イメージ

従来品



変更品



シールの貼付向きを変更いたします。

2. 検定合格年月日の表示変更

検定合格年月日は6桁(年:西暦下2桁、月:2桁、日:2桁)の表示に変更いたします。

従来品

検定合格年月日

1234, 56, 78

変更品

検定合格年月日

345678

検定合格年月日の表示はイメージです。
実際の表示とは異なります。

●変更品表示

当分の間、個装箱には **製造番号シール変更品** と表示いたします。段ボール箱には **包装変更品** と記載したテープを使用いたします。

●変更品の出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
ロタテック®内用液	2mL 1チューブ	185-80844-6	R032703	2019年8月

※包装変更品の出荷時期は、弊社在庫状況により、出荷予定時期と異なる場合がございますのでご了承ください。

MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

製品のお問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター
医療関係者の方 ☎ 0120-024-961

<受付時間> 9:00 ~ 17:30 (土日祝日・当社休日を除く)

RT-06
201907